

SISTEMA gENiO[®]



SAPIENS[®]
La naturaleza es sabia...



BIORRESONANCIA CUÁNTICA

MANUAL TÉCNICO

Ver. 2025.2.0.0



ÍNDICE DE CONTENIDO

| | |
|---|----|
| Objetivo de este documento | 02 |
| Acerca de la empresa | 02 |
| Cuidados del sistema | 03 |
| Información de propiedad intelectual | 05 |
| Atención al cliente & soporte técnico | 05 |
| Declaración de no conformidad para la UE | 06 |
| Limitación de responsabilidad | 07 |
| Medidas nominales & partes | 08 |
| DISEÑO DE PANEL LED | 08 |
| Instrucciones de ensamblaje | 09 |
| Diagramas de circuitos eléctricos placa principal | 10 |
| Diagramas de circuitos eléctricos panel LEDS | 10 |
| Listado de partes placa madre | 11 |
| Listado de partes panel de seguridad | 12 |
| Listado de partes pantalla LED | 12 |
| Herramientas de desarrollo del software | 13 |
| Requerimientos mínimos del Hardware | 13 |
| Requerimientos mínimos del Software | 13 |
| Requerimientos mínimos | 14 |
| Instalación de pre-requisitos | 15 |
| Listado de pre-requisitos del Software | 18 |
| Acerca de... | 18 |
| 1. Apertura del sistema | 19 |
| 2. Acceso (contraseña) | 20 |
| 3. Repertorización / Propedéutica | 21 |
| 3. Repertorización / Propedéutica (Para imprimir) | 22 |
| 4. Sincronización | 26 |
| 5. Análisis | 27 |
| 6. Terapia de biorresonancia cuántica | 29 |
| 6. Terapia holística & integrativa | 29 |
| 6. Ménu de terapias | 30 |
| 7. Cierre de sesión | 31 |
| Elementos comunes | 32 |
| Especificaciones generales | 33 |
| Consideraciones de diseño | 34 |
| Licencia de uso del Software | 36 |
| Etiqueta del sistema | 37 |
| Presentación comercial | 38 |
| Notas del usuario | 38 |

OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO

La finalidad de este manual técnico es la de proporcionar al lector las pautas de desarrollo y configuración del sistema gENiO en lo concerniente a su hardware (caja de interfaz 'Constelación'), y su software ('Genio'), así como su instalación, activación, puesta en marcha e introducción a sus conceptos básicos de navegación.

Este manual no pretende ser un curso de aprendizaje de cada una de las herramientas / aplicativos proporcionados en el software o las herramientas empleadas en el desarrollo del software; sino documentar la parte física y la parte no-física del sistema.

Para un mayor detalle acerca de cada una de las unidades o temas específicos, y su forma de aplicación y operación, se recomienda consultar la documentación respectiva para cada una de ellas encontradas en el servidor Web que el desarrollador indique en su momento.

ACERCA DE LA EMPRESA

Comunicación Bioinstrumental, SL es una sociedad legalmente constituida el día 7 de diciembre de 2021 ante la Registradora Mercantil de Barcelona - España. La escritura de constitución de la Sociedad expedida en documento notarial GF8326259 número 6.970 del 3 de diciembre de 2021, establece como 'Objeto Social' actividad principal económica el siguiente numeral de actividades económicas: 58.29 / Edición de otros programas informáticos y otras actividades económicas en los siguientes numerales: 62.09 / Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática, 62.01 / Actividades de programación informática, 63.11 / Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas, 47.41 / Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados. La Sociedad aparece con número de entrada del registro 1/2021/41153159 y con tarjeta de identificación fiscal - CIF: B67857334.

CUIDADOS DEL SISTEMA



El sistema solamente debe usarse en entornos con una temperatura ambiental comprendida entre los 5 °C (41 °F) y los 35 °C (95 °F).



Asegúrese que el cable de conexión USB-USB esté perfectamente acoplado en ambos conectores del ordenador y la caja de interfaz 'Constelación'.



El equipo portátil puede calentarse durante el uso o durante la carga de la batería. No deje el equipo (caja de interfaz y ordenador / computadora), sobre sus piernas o cualquier otra parte de su cuerpo para evitar molestias o daños causados por el calor. No coloque el equipo sobre superficies que puedan impedir su correcta ventilación o circulación del aire.



No utilice cables de alimentación, accesorios ni otros dispositivos que estén dañados.



Mientras el equipo esté encendido, asegúrese de no transportar o cubrir el equipo con ningún material que pueda reducir la circulación del aire.



No coloque el equipo sobre superficies de trabajo irregulares o inestables.



El equipo puede ser inspeccionado por máquinas de rayos X (utilizadas en elementos colocados en cintas transportadoras), pero no se puede exponer a detectores magnéticos o exploradores de mano.



Cuando utilice el equipo durante un vuelo pregunte al personal de la aerolínea para conocer los servicios disponibles en vuelo y las restricciones que son necesarias seguir.



Desconecte los cables de alimentación antes de limpiar el equipo. Utilice una esponja o gamuza de celulosa humedecida con una solución de 90% agua y 10% alcohol. Elimine cualquier resto de humedad del equipo utilizando un paño seco. Para evitar cortocircuitos o corrosión, evite que entren líquidos en el chasis del equipo.



Nunca aplique disolventes fuertes, como por ejemplo diluyentes, benceno u otros productos químicos, en las superficies del equipo o cerca de este.



En particular preste atención a la limpieza de la bandeja de análisis del sistema, evite tocarla directamente con sus dedos ya que esto podrá afectar los resultados del análisis.



No coloque ningún objeto sobre el sistema o utilice el sistema para sujetar o mantener en su sitio otro objeto.



No exponga el equipo a campos magnéticos o eléctricos intensos. Durante su uso es mejor mantener los dispositivos móviles u otros objetos electrónicos activos alejados del sistema.



No exponga el equipo a líquidos, lluvia o humedad ni lo use en lugares en los que se den esas condiciones.



No exponga el equipo a entornos polvorientos o utilice el equipo cerca de fugas de gas.



No utilice el ordenador del equipo para la minería de criptomonedas (consumirá una gran cantidad de electricidad y tiempo para obtener una moneda virtual convertible) o actividades relacionadas.



Cuando tenga que desechar el sistema por favor asegúrese de revisar las regulaciones locales en referencia a los desechos electrónicos.

INFORMACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Comunicación Bioinstrumental, S.L. proporciona esta publicación 'tal y como está' sin ninguna garantía de ningún tipo, ni expresa ni implícita, incluidas, pero sin limitarse a, las garantías implícitas o condiciones de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. En ningún caso Comunicación Bioinstrumental, S.L., sus propietarios, directores, directivos, empleados, representantes, distribuidores o agentes serán responsables de ningún daño indirecto, especial, incidental o consecuente (incluidos los daños causados por pérdida de beneficios, pérdida de negocio, pérdida de uso o datos, interrupción del negocio y casos similares), aunque Comunicación Bioinstrumental, S.L. hubiera recibido notificación de la posibilidad de tales daños que surjan de cualquier defecto o error en este manual.

Los productos y nombres de empresas que aparecen en este manual pueden o no ser marcas registradas o propiedades intelectuales de sus respectivas compañías y solamente se usan para identificación o explicación y en beneficio de los propietarios sin intención de infringir ningún derecho.

Las especificaciones e información contenidas en este manual se proporcionan sólo a título informativo y en cualquier momento pueden cambiar sin previo aviso, y no se deben considerar como una obligación para Comunicación Bioinstrumental, S.L. Así mismo Comunicación Bioinstrumental, S.L. no asume ninguna responsabilidad por ningún error o imprecisión que pudiera aparecer en este manual, incluidos los productos y el software descrito en él.

Copyright © 2023 Comunicación Bioinstrumental, S.L. Todos los derechos reservados.

ATENCIÓN AL CLIENTE & SOPORTE TÉCNICO

Visite nuestro sitio web en <http://www.bioinstrumentalcuantica.com>

Comunicación Bioinstrumental, S.L. ofrece varias funciones de soporte técnico que incluyen solución de problemas, optimización de rendimiento de sus productos, integración de sus diferentes desarrollos de software.

DECLARACIÓN DE NO CONFORMIDAD PARA LA UE


Nombre del fabricante: Comunicación Bioinstrumental, S.L.
Dirección: Sepúlveda 46, 2 2, Barcelona – 08015, España

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la NO conformidad del producto CAJA DE INTERFAZ CONSTELACIÓN, al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos, de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014.

El equipo cuenta con los siguientes accesorios: 1. Ordenador / Computadora fabricado por terceras partes. 2. Cable conector USB-USB fabricado por terceras partes. 3. Paquetes de software 'gENiO Sapiens'.

Información adicional: La CAJA DE INTERFAZ CONSTELACIÓN es parte del sistema gENiO de biorresonancia cuántica, que funciona a muy bajo voltaje alimentado por el ordenador / computadora a través del cable USB-USB y NO es un sistema médico ya que la biorresonancia cuántica NO está reconocida por ningún gobierno o entidad oficial competente.

La mayoría de los puertos USB de la computadora suministran 5V de electricidad con una corriente máxima de 0.5A. Esta cantidad de corriente es estándar en la mayoría de los ordenadores / computadoras y significa que la potencia de salida general será de 2,5 vatios en el mejor de los casos. Los diseños USB posteriores elevan esa corriente hasta 0.9A lo cual no representa ningún riesgo medible para cualquier organismo viviente.

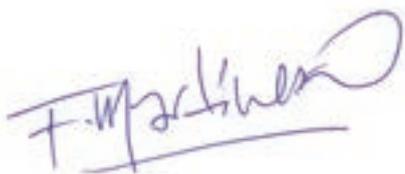

Barcelona - España, 22/06/2023
Francisco Martínez
Gerente / Propietario

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

LA INFORMACIÓN, LOS PROGRAMAS O LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR NUESTRAS EMPRESAS NO SUSTITUYEN NINGÚN CONSEJO O TRATAMIENTO PROFESIONAL, INCLUYENDO EL CONSEJO Y EL TRATAMIENTO DE UN PROFESIONAL DE LA SALUD CON LICENCIA.

Debe consultar a su médico u otro profesional de la salud antes de comenzar este o cualquier otro programa relacionado con la salud para determinar si es adecuado para sus necesidades. La información que se ofrece a través de nuestro software es solo educativa y no reemplaza el consejo, diagnóstico o tratamiento médico profesional.

Si tiene preguntas o situaciones que requieren asesoramiento profesional o médico, debe consultar con un especialista debidamente capacitado y calificado, como un médico con licencia, psicólogo u otro profesional de la salud.

Nunca ignore el consejo médico de un psicólogo u otro profesional de la salud, ni se demore en buscar dicho consejo debido a la información ofrecida o proporcionada dentro o a través del programa, los servicios o el sitio web.


Si actualmente está siendo tratado por un médico u otro profesional de la salud por cualquier condición o enfermedad, no modifique su programa de tratamiento sin la guía de su proveedor o basándose en la información que se ofrece en este documento.

Si ha experimentado un trauma de cualquier tipo, le recomendamos que trabaje con un terapeuta capacitado y con licencia o un profesional de la salud mental. Nuestros servicios y ofertas no están destinados a tratar, diagnosticar, sanar o curar ningún trauma o enfermedad o condición mental o física.

La biorresonancia cuántica NO está reconocida por ningún ente oficial o gubernamental como una disciplina médica ya que los campos polimórficos con los que se interactúan durante una sesión NO pueden ser medidos matemáticamente con los sistemas de medición actuales.

Copyright © 2023 Comunicación Bioinstrumental, S.L. Todos los derechos reservados.

MEDIDAS NOMINALES & PARTES





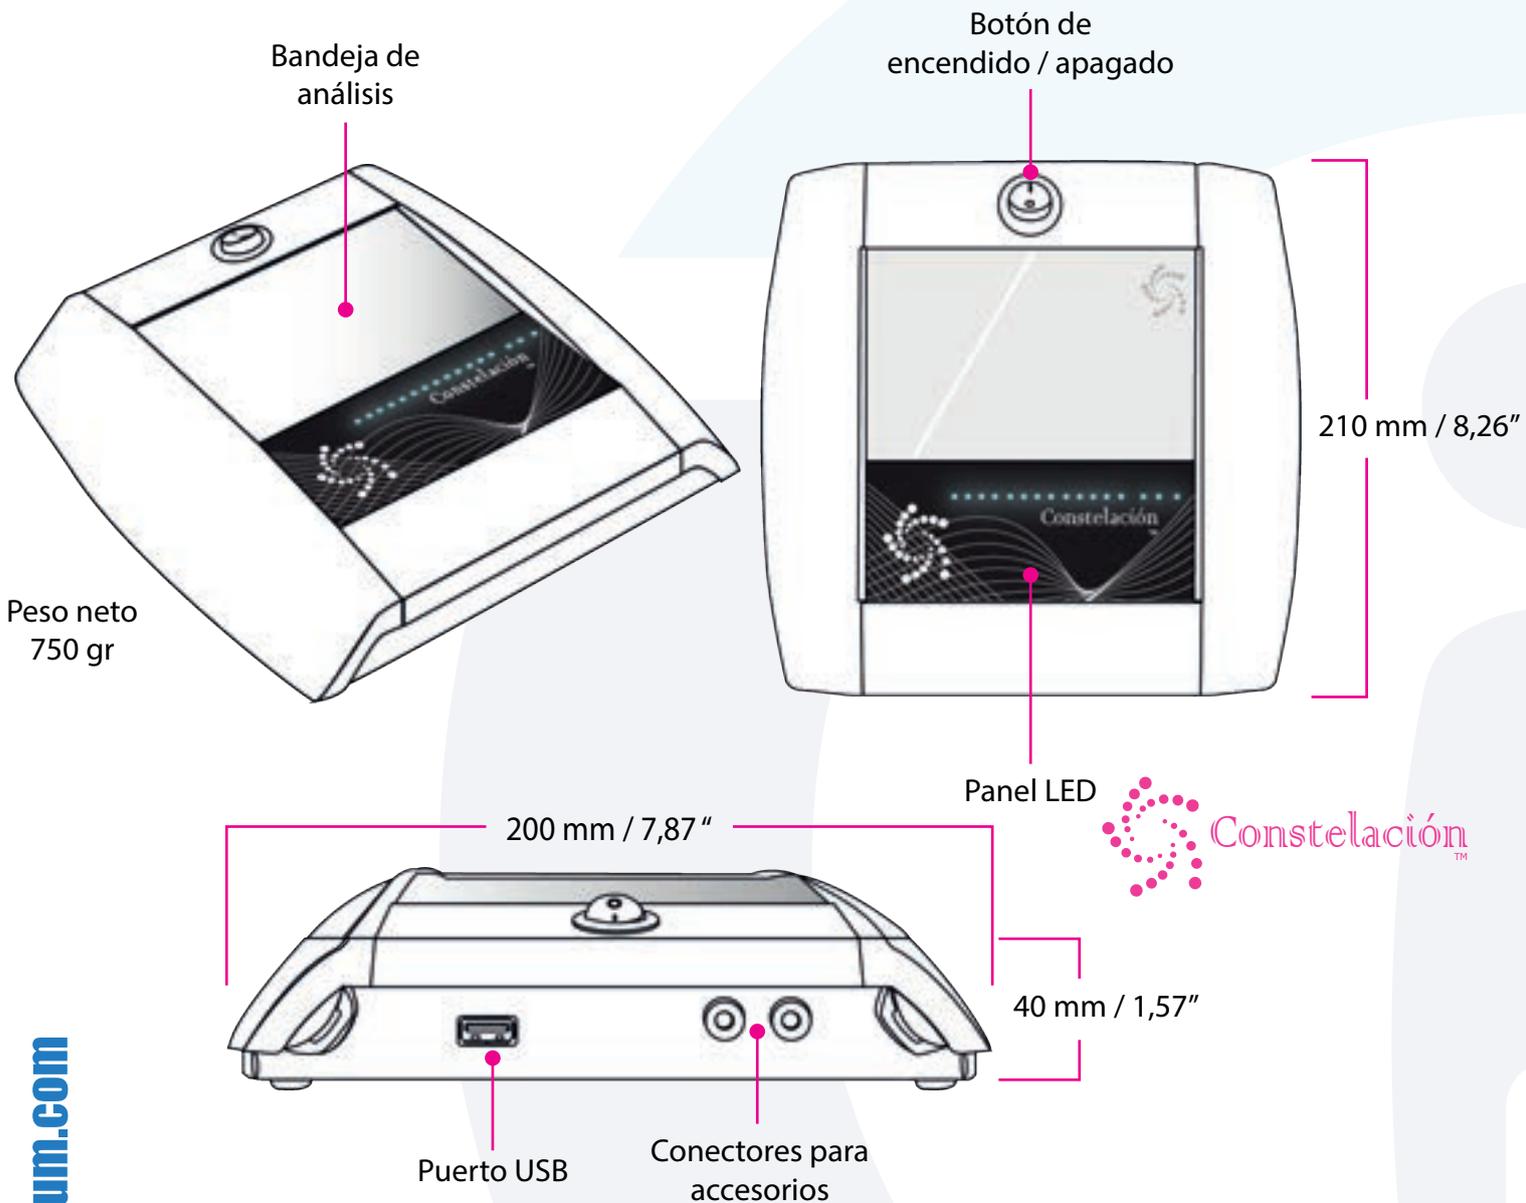


www.sapiensquantum.com

DISEÑO DE PANEL LED



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

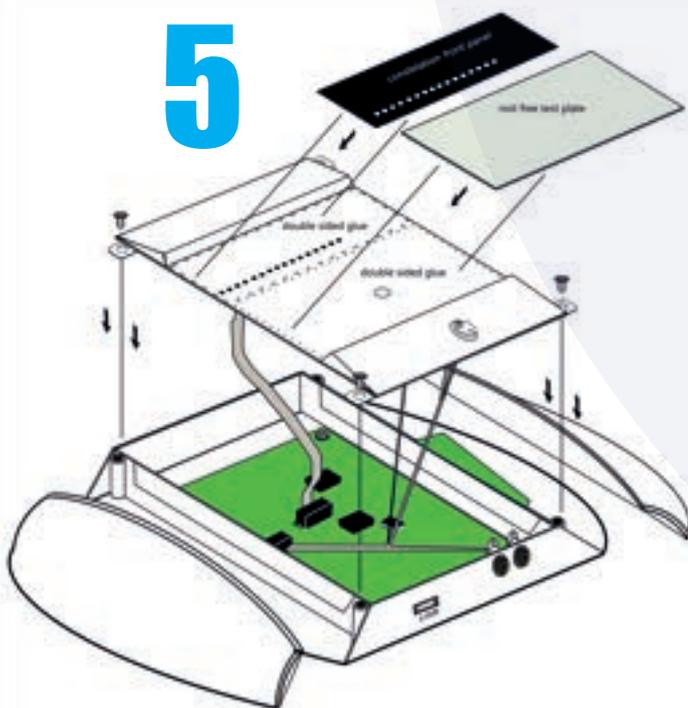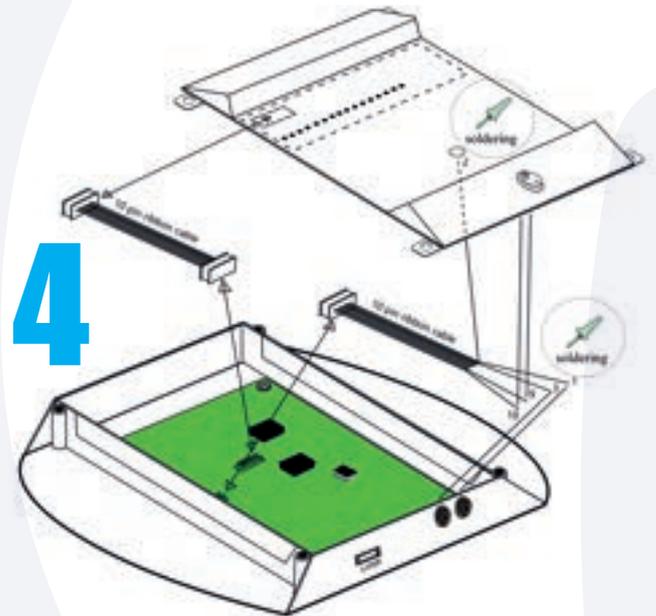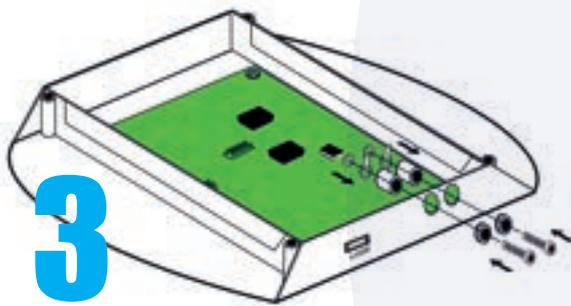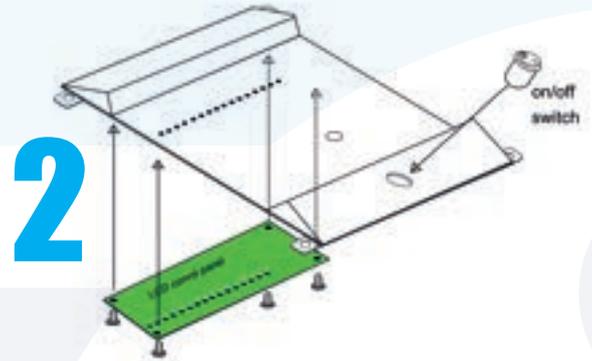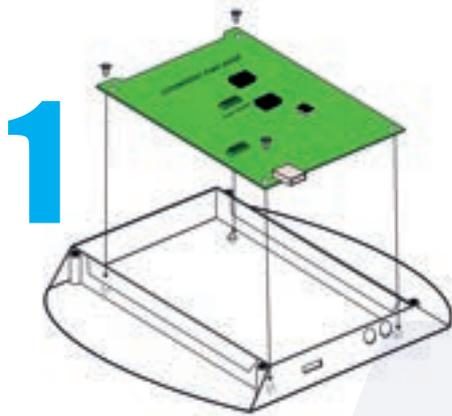

Final USB Test Program



USB connection PC

LISTADO DE PARTES PLACA MADRE

www.sapiensquantum.com

| ITEM | QTY | REFERENCE | PART |
|------|-----|---|----------------------------|
| 1 | 1 | CN1 | USB_A |
| 2 | 2 | C1, C4 | 33p |
| 3 | 2 | C2, C5 | 10n |
| 4 | 9 | C3, C7, C8, C9, C10, C14, C16, C17, C18 | 1u |
| 5 | 3 | C11, C12, C13 | 100u |
| 6 | 1 | C15 | 4n7 |
| 7 | 2 | C19, C20 | 27p |
| 8 | 8 | C21, C22, C25, C26, C27, C28, C29, C30 | 100n |
| 9 | 2 | C23, C24 | 100p |
| 10 | 1 | F1 | R0501095 |
| 11 | 1 | H1 | PE1540P |
| 12 | 7 | J2, J12, J13, J14, J19, J20, J35 | CON1 |
| 13 | 2 | J4, J34 | PRG |
| 14 | 1 | J31 | DISP |
| 15 | 1 | J32 | HEAD |
| 16 | 1 | J33 | LIMB |
| 17 | 1 | J36 | CON10 |
| 18 | 1 | J37 | CON6 |
| 19 | 1 | L1 | 10u |
| 20 | 1 | R1 | 1M |
| 21 | 7 | R2, R15, R21, R22, R51, R44, R45 | 100K |
| 22 | 3 | R5, R47, R49 | 1K |
| 23 | 1 | R6 | 3K9 |
| 24 | 6 | R8, R12, R13, R14, R18, R43 | 10K |
| 25 | 1 | R9 | 20K |
| 26 | 1 | R10 | 300 |
| 27 | 1 | R11 | 680K |
| 28 | 5 | R16, R19, R20, R48, R50 | 330 |
| 29 | 2 | R17, R23 | 680 |
| 30 | 15 | R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R52, R53, R54 | 4K7 |
| 31 | 2 | R39, R40 | 27R |
| 32 | 1 | R41 | 1K5 |
| 33 | 1 | R46 | 470 |
| 34 | 1 | R55 | 2.2K |
| 35 | 1 | U1 | AD9832 BRU |
| 36 | 2 | U2, U6 | TLC7528C |
| 37 | 1 | U17 | MCP604 I/SL |
| 38 | 1 | U4 | CD22M3493Q vagy MT093AP |
| 39 | 1 | U5 | 16F871-I/L |
| 40 | 1 | U7 | FT232BL |
| 41 | 1 | U8 | HC4094M |
| 42 | 1 | U9 | ZMD U6264BS2C- 07LL |
| 43 | 2 | U10, U11 | 6N137 |
| 44 | 1 | U12 | TMA0505S |
| 45 | 1 | U13 | 74HC00D |
| 46 | 1 | U14 | 93LC66B |
| 47 | 3 | U15, U16, U21 | HCT157 |
| 48 | 5 | U18, U20, U23, U26, U27 | HC14 |
| 49 | 1 | U22 | HC393 |
| 50 | 1 | U24 | PIC16F628- 04/so |
| 51 | 1 | X1 | 8MHz |
| 52 | 1 | X2 | 20MHz |
| 53 | 1 | X3 | 6MHz |

LISTADO DE PARTES

PANEL DE SEGURIDAD

| ITEM | QTY | REFERENCE | PART |
|------|-----|--|-------------|
| 54 | 2 | C31, C32 | 330nF |
| 55 | 11 | C33, C34, C38, C40, C43, C44, C49, C50, C51, C52, C53 | 100nF |
| 56 | 7 | C35, C41, C42, C54, C55, C56, C57 | 470nF |
| 57 | 2 | C36, C45 | 1nF |
| 58 | 1 | C37 | 10nF |
| 59 | 2 | C39, C48 | 2.2uF |
| 60 | 2 | C46, C47 | 10p |
| 61 | 6 | R56, R57, R58, R58, R60, R61 | 47K |
| 82 | 1 | R62 | 100 |
| 83 | 1 | R63 | 10k |
| 84 | 1 | R64 | 27K |
| 85 | 1 | R65 | 12K |
| 86 | 1 | R66 | 1.5K |
| 87 | 12 | R67, R68, R69, R70, R73, R74, R75, R76, R77, R78, R79, R80 | 1.3K |
| 88 | 2 | R71, R72 | 33K |
| 89 | 1 | R81 | 1K |
| 90 | 2 | U17, U18 | L78L33 |
| 91 | 1 | U19 | AT91SAM7S64 |
| 92 | 2 | U20, U21 | TLC084 |
| 93 | 1 | X4 | 18.432Mhz |
| 94 | 5 | J31, J32, J33, J36, J38 | CONN_5x2 |
| 95 | 1 | J37 | CONN_6x1 |

LISTADO DE PARTES PANTALLA LED

| ITEM | QTY | REFERENCE | PART |
|------|-----|---|---------|
| 1 | 2 | C1, C2 | 100n |
| 2 | 16 | D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16 | LED |
| 3 | 1 | J1 | CON10 |
| 4 | 16 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16 | 1K |
| 5 | 2 | U1, U2 | HC4094M |

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DEL SOFTWARE

Embarcadero Delphi, antes conocido como CodeGear Delphi, Inprise Delphi y Borland Delphi, es un entorno de desarrollo de software diseñado para la programación de aplicaciones multiplataforma con énfasis en la programación visual. En Delphi se utiliza como lenguaje de programación una versión moderna de Pascal llamada Object Pascal. Es producido comercialmente por la empresa Embarcadero Technologies desde mayo de 2008, tras adquirir CodeGear (antes lo desarrollaba Borland). En sus diferentes variantes, permite producir archivos ejecutables para Windows, MacOS X, iOS, Android, GNU/Linux y la plataforma .NET.

MySQL es un manejador de Bases de Datos, el cual permite múltiples hilos y múltiples usuarios, fue desarrollado como software libre. Es libre para uso en Servidores WEB. Ofrece ventajas tales como fácil adaptación a diferentes entornos de desarrollo, Interacción con Lenguajes de Programación como PHP, Java Script, Pascal y es de fácil Integración con distintos sistemas operativos de 'Windows' o 'Mac'.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL HARDWARE

Procesador: Core i7
Memoria RAM: 8 GB
Disco duro: 512 GB

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SOFTWARE

Privilegios de Administrador
Sistema Operativo: Windows 11

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

gENiO Sapiens requiere de unas especificaciones mínimas de la máquina (ordenador / computadora), donde se va a instalar para funcionar adecuadamente.

La 'memoria RAM': 'RAM' es sigla de Random Access Memory ('memoria de acceso aleatorio'), donde el Sistema Operativo almacena los datos a corto plazo necesarios para cualquier tarea que se realice para que las aplicaciones funcionen.

La memoria RAM mínima para ejecutar adecuadamente gENiO Sapiens es 8 Gb.

La 'Arquitectura de un ordenador / computadora' hace referencia a como una máquina es ensamblada y los diferentes componentes que se usan en su fabricación. En cuanto a memoria RAM, si bien es cierto que muchas permiten su ampliación - en nuestra experiencia, la máquina no funciona a su mejor potencial por lo que en realidad tales ampliaciones de memoria solo las recomendamos si el técnico que presta el servicio sabe lo que está haciendo.

Las consideraciones más importantes son la del CPU y la RAM. Otras consideraciones como por ejemplo el tipo de tarjeta gráfica son consecuencia de las dos anteriores.

Otro componente importante a tener en cuenta es el tipo de procesador, CPU o Unidad Central de Procesamiento - un pequeño chip cuya función es enviar / recibir datos y ejecutar cálculos entre otras.

El procesador mínimo considerado para gENiO Sapiens es del tipo 'iCore7'.

La etapa 5 'ANÁLISIS' durante una sesión gENiO es la que hace más acopio de estas características mínimas para realizar todo el procedimiento dentro de un tiempo razonable de entre 30 y 60 segundos.

¿Cómo saber qué tipo CPU y RAM tiene una máquina?

Barra de tareas de 'Windows'

1 Pulsar el icono 'Explorador de archivos' en la barra de tareas de 'Windows'.

2 Pulsar la opción 'Propiedades' para desplegar el cuadro de diálogo 'Sistema > Información'.

The image shows a Windows taskbar with the File Explorer icon highlighted. A blue arrow points from the taskbar to the File Explorer window. Another blue arrow points from the File Explorer window to the 'Sistema > Información' window. The 'Sistema > Información' window displays system specifications for a laptop.

| Especificaciones del dispositivo | |
|----------------------------------|--|
| Nombre del dispositivo | LAPTOP-K6MOCVST |
| Procesador | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz |
| RAM instalada | 16,0 GB (15,7 GB usable) |
| Identificador de dispositivo | D6F52946-5579-44A5-94BE-705859FBACA1 |
| Id. del producto | 00325-82256-67080-AAOEM |
| Tipo de sistema | Sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64 |
| Lápiz y entrada táctil | La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla |

| Especificaciones de Windows | |
|-------------------------------|---|
| Edición | Windows 11 Home |
| Versión | 22H2 |
| Instalado el | 12/19/2022 |
| Versión del sistema operativo | 22621.1555 |
| Experiencia | Windows Feature Experience Pack 1000.22640.3000.0 |

INSTALACIÓN DE PRE-REQUISITOS

- 1**
- Descargar el archivo instalador pegando el siguiente vínculo en la barra de búsqueda del navegador de Internet: https://www.mediafire.com/file/32vyxxufgbyj9yf/Noe_gENiO.zip/file
 - Para que una vez la descarga haya finalizado se pueda abrir el archivo facilmente, descargar e instalar el programa '7 Zip': <https://www.mediafire.com/file/yc6gx9a0mz9l2xj/7z2201-x64.exe/file>






• En la ventana emergente que se muestra, pulse el botón 'DOWNLOAD'.

• Es posible que la página de descarga de 'Mediafire' muestre un mensaje. Pulsar el botón 'I Accept'.



- 2**
- Pulsar con el botón derecho del ratón para desplegar el menú contextual.
 - Pulsar sobre la opción 'Mostrar más opciones'.
 - Seleccionar '7-Zip'.
 - Seleccionar 'Extraer en 'Noe_gENiO\.'

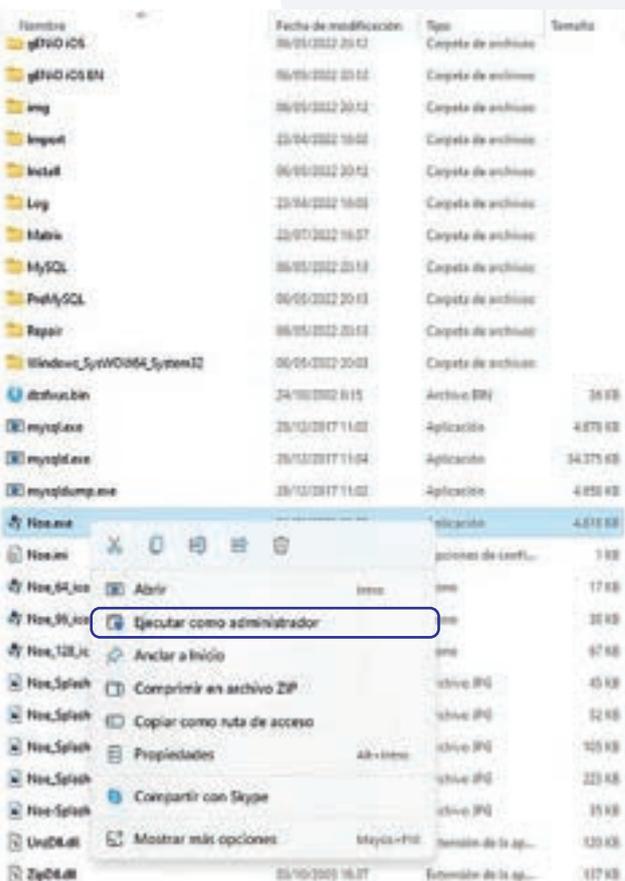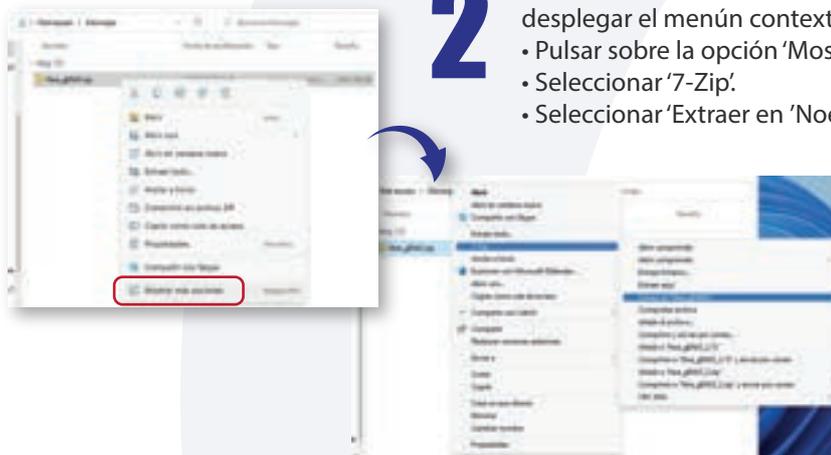

- 3**
- Abra el directorio o ruta donde se descargó el archivo y pulse sobre el directorio 2 veces.
 - Pulsar con el botón derecho del ratón sobre 'Noe.exe'.
 - Pulsar 'Ejecutar como administrador'.


4

- Seleccionar o asegurarse que la opción de idioma está en 'Castellano'.
- Pulsar sobre la opción 'Instalación / Actualizaciones'.



5

- Es posible que la primera vez el Sistema Operativo intente bloquear algunas características de 'Noé'. Pulsar 'Permitir acceso'.
- Pulsar el botón 'Instalación de MySQL'.

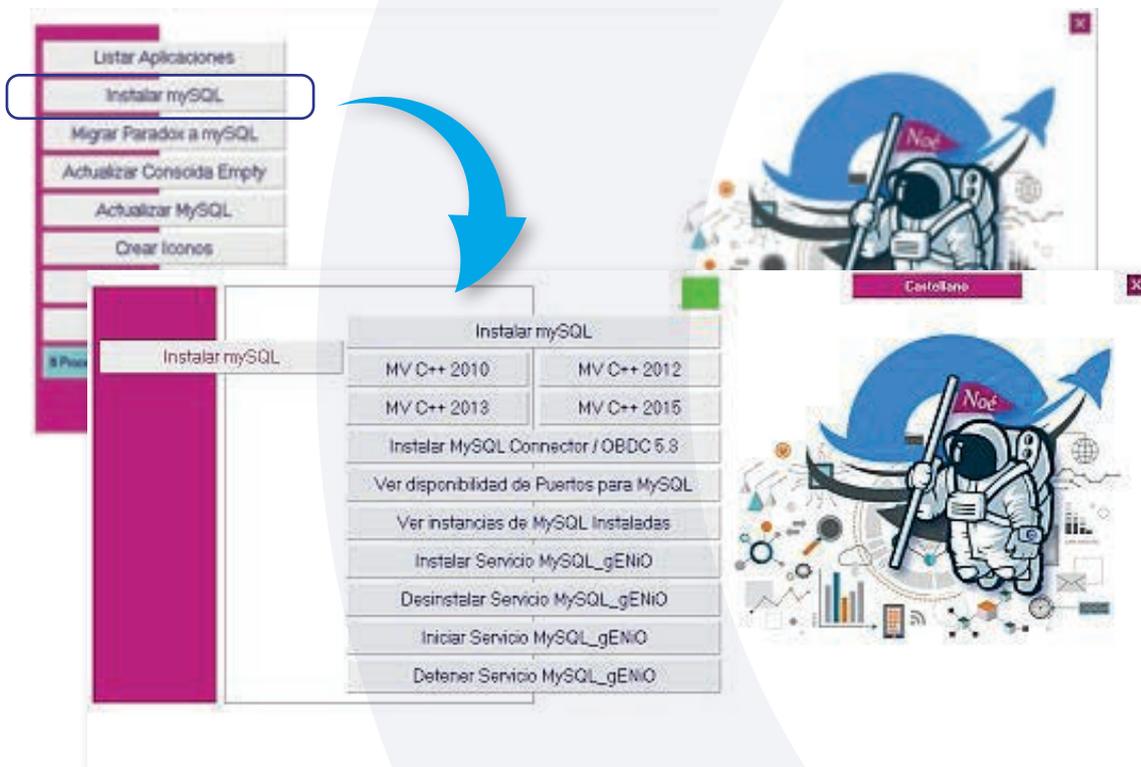

• Pulse en orden los siguientes botones y siga las instrucciones de cada ventana emergente para realizar la instalación:

6

1. Instalar MySQL
2. MV C++ 2010
3. MV C++ 2012
4. MV C++ 2013
5. MV C++ 2015
6. Instalar MySQL Connector OBDC 5.3
7. Instalar Servicio MySQL_gENiO
8. Iniciar Servicio MySQL_gENiO

6A

En caso de que al pulsar alguno de los botones marcados del 1 al 6, el programa no inicie la instalación entonces deberá:

- Abrir el directorio 'Noe_gENiO' pulsando 2 veces sobre este.
- Localize y abra el directorio 'PreMySQL'.
- Pulse en orden descendente 2 veces sobre cada archivo.
- Siga las instrucciones en cada ventana emergente para realizar la instalación.

Los botones 7 y 8 solo se deben ejecutar desde 'Noé'.

| Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tam |
|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----|
| Actualizacion | 09/08/2022 13:02 | Carpeta de archivos | |
| ActualizacionEN | 09/08/2022 13:02 | Carpeta de archivos | |
| BackUps | 28/09/2021 0:00 | Carpeta de archivos | |
| Codigo | 09/08/2022 13:02 | Carpeta de archivos | |
| gENiO iOS | 09/08/2022 13:02 | Carpeta de archivos | |
| gENiO iOS EN | 09/08/2022 13:02 | Carpeta de archivos | |
| img | 09/08/2022 19:53 | Carpeta de archivos | |
| Import | 20/04/2021 7:33 | Carpeta de archivos | |
| Install | 09/08/2022 13:03 | Carpeta de archivos | |
| Log | 09/12/2020 14:15 | Carpeta de archivos | |
| Matrix | 09/08/2022 13:03 | Carpeta de archivos | |
| MySQL | 09/08/2022 13:03 | Carpeta de archivos | |
| PreMySQL | 09/08/2022 13:03 | Carpeta de archivos | |
| Repair | 09/08/2022 13:03 | Carpeta de archivos | |
| dzsfus.bin | 24/10/2002 0:15 | Archivo BIN | |
| mvsol.exe | 08/12/2017 11:02 | Aplicación | |

| Nombre | Fecha de modificación | Tipo |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| MVC2010_x86.exe | 20/10/2020 5:47 | Aplicación |
| MVC2012_x86.exe | 20/10/2020 5:47 | Aplicación |
| MVC2013_x86.exe | 20/10/2020 5:48 | Aplicación |
| MVC2015_x86.exe | 13/10/2020 17:34 | Aplicación |
| mysql-connector-odbc-5.3.4-win32.msi | 11/02/2016 17:00 | Paquete de Windo... |

- Es posible que al intentar instalar alguno de los archivos MVC, el sistema despliegue un mensaje de error, esto se debe a que ya tiene instalado algún otro archivo MVC. Si desea antes de proceder a la instalación pulse el botón 'Listar Aplicaciones' para ver que archivos MVC tiene instalados.

Listar Aplicaciones

Instalar MySQL

Migrar Paradox a MySQL

Actualizar Consolida Empty

Actualizar MySQL

Crear Iconos

Optimizar MySQL

Reparar MySQL

Procesadores: 4 RAM: 3129M / 8Gb

Inte[R] C++ Redistributable for Windows on Intel[R] 64

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable - x86 9.0.30729.17

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4140

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161

Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030

Microsoft Visual C++ 2012 x86 Additional Runtime - 11.0.50727

Microsoft Visual C++ 2012 x86 Minimum Runtime - 11.0.61030

Microsoft Visual C++ 2012 x86 Minimum Runtime - 11.0.50727

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30901

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.40649

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.40650

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30901

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.40650

Microsoft Visual C++ 2013 x86 Additional Runtime - 12.0.40650

Microsoft Visual C++ 2013 x86 Minimum Runtime - 12.0.40650

Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) - 14.27.26014

Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86) - 14.24.2612

Microsoft Visual C++ 2019 x86 Additional Runtime - 14.24.26127

Microsoft Visual C++ 2019 x86 Minimum Runtime - 14.24.26127

Inte C++ y MySQL Instalados: 20

Aceptar




LISTADO DE PRE-REQUISITOS DEL SOFTWARE

1. Microsoft Visual C++ 2010
2. Microsoft Visual C++ 2012
3. Microsoft Visual C++ 2013
4. Microsoft Visual C++ 2015
5. MySQL Connector/ODBC 5.3
6. DivX5.11Bundle
7. BDE 5.02 / FTDI CDM Drivers 2.08.02

ACERCA DE ...



Powered By:




gENOB Sapiens
Versión 2023.10.0.0
© Francisco Martínez 2010-2023
© Laboratorio Tecnonatura, SAS 2012-2023
© Comunicación Bioinstrumental, SL 2022-2023
Reservados todos los derechos
www.bioinstrumentalcuantica.com
c.bioinstrumental@gmail.com
ESPAÑA: +34 647 550 324
COLOMBIA: +57 320 842 5548

Aún cuando de acuerdo a nuestra clase de registro NO es necesario, este software se ha desarrollado para cumplir los requisitos de la certificación 'Medical Device Software' Clase A de acuerdo con los criterios del estándar IEC 62304 conforme con ISO 13485, para cubrir en particular 'Stand alone medical software'.

De la misma manera este software ha sido desarrollado para cumplir con los estándares de desarrollo ISO/IEC/IEEE 12207-2017 International Standard of Systems and Software engineering and Software life cycle processes.



AGRADECIMIENTOS

Adriana Guntas (Cascais - Portugal / Sao Paulo - Brazil)
Candelaria Canto (Mérida - México)
Eduardo Coelo (Benidorm - España)
Ivonne Patricia Arfanduga Parra (Bogotá - Colombia)
Olga Lucia González Cobos (Bogotá - Colombia)

**AVISO LEGAL +
DEROGACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

Este es un sistema de biorresonancia cuántica que además trabaja con campos de indeterminancia cuántica. Ningún gobierno o entidad competente reconoce los datos o la efectividad de estos dispositivos porque actualmente no se posee la tecnología para ser medidos, por lo que cualquier testimonio dado por una persona que se ha visitado con este sistema debe ser atendida como una 'anécdota personal'.

Este sistema es una herramienta educativa y debe ser usada como tal, solamente un médico colegiado puede referirse a sus clientes o visitas como 'pacientes', así mismo solamente él o ella pueden diagnosticar una condición. No aceptamos ninguna responsabilidad directa o indirecta derivada de la aplicación de la información para la 'REDUCCIÓN DEL ESTRÉS' contenida en nuestros productos.

Los logos de nuestras 'Apps externas' hacen referencia a la constante conexión entre cuerpo, alma y mente. Como estas constantemente fluyen entrelazándose la una con la otra e interactuando infinitamente para así construir una imagen de lo quienes SOMOS :)













Constelación



Nirvana 360



Muchas gracias por tu confianza!









1 APERTURA DEL SISTEMA

Antes de iniciar gENiO® Sapiens ha de asegurarse que la caja de interfaz 'Constelación' está bien conectada a uno de los puertos 'USB' del ordenador, y que la caja está encendida - a este efecto una de las 'LED' se iluminará.

1. Localice el 'Icono de acceso' a gENiO® Sapiens y pulse sobre 2 veces. El mismo puede estar en el 'Escritorio de Windows' y/o anclado en la 'Barra de tareas de Windows'.
2. Un 'splash' o 'pantalla de inicio' se visualizará en el 'escritorio de Windows', acompañado de una melodía que indican la carga del programa, al tiempo que una barra de progreso marca el procedimiento.
3. Cuando la 'barra de progreso' alcance el 94% se visualizará el panel 'establecimiento de comunicación' software <-> caja de interfaz.
4. Una vez alcanzado el 100% de la carga del programa se visualizará la pantalla principal de menú con la opción de 'Acceso' o 'Contraseña' habilitada.

IMPORTANTE

En caso de que al alcanzar el 94% de carga, el software no pudiera establecer comunicación con la caja de interfaz, se deberán seguir las instrucciones apropiadas - brindadas en la documentación técnica del sistema.

gENiO® Sapiens no funcionará sin que se haya establecido comunicación con la caja de interfaz.

ETAPAS DE SESIÓN

Apertura

Inicio de gENiO® Sapiens desde el 'Escritorio de Windows' -> icono de acceso directo. Carga de bases de datos y establecimiento de comunicación con la caja de interfaz.

Repertorización


Carga de toda la información de la visita. Posibilidad de llenar múltiples cuestionarios para 'crear consciencia' (ISO) y para determinar factores relevantes.

Análisis



Detección de valores relativos de 'reactividad' de la persona frecuencias cuánticas de 260.000 ítems pre-grabadas en gENiO® Sapiens -> Curso de terapia.

Cierre

Última etapa donde se hacen 'últimos retoques' a la terapia para maximizar los resultados y preparar al organismo para el fin del ciclo estimulativo.

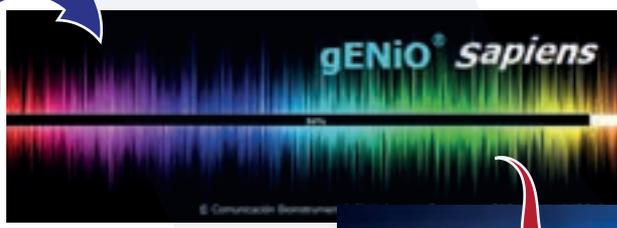

94%
Establecimiento de comunicación con caja de interfaz

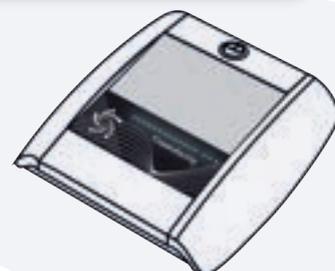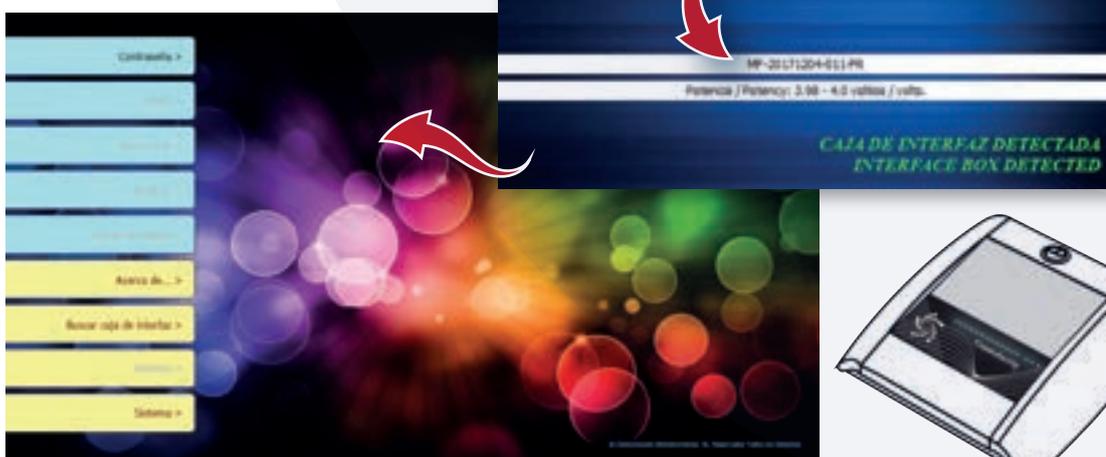

2 ACCESO (CONTRASEÑA)

Este es el primer contacto que se tiene con gENIO® Sapiens, una vez este ha sido cargado en la memoria temporal del ordenador. El acceso es la puerta de entrada al programa, a todas sus funciones, bondades y beneficios... aquí se inicia la 'Experiencia gENIO Sapiens' ...



www.sapiensquantum.com

Esta estimulación se utiliza para limpiar energías residuales negativas, posible contaminación electromagnética y larvas

La primera vez que el usuario accede al programa deberá crear su propia contraseña.

Nombre del terapeuta que realizará la sesión

Botón para re-setear nombre del terapeuta y regresar al 'Administrador' del sistema.

Botón para cerrar el panel.



Este botón es solo visible si en el día que se use el software es el aniversario de alguna persona que con sus descubrimientos o trabajo, ha contribuido para que esta tecnología sea posible.

Abre la unidad 'Facultad' donde se puede escribir una oración o mantra o cualquier información que el usuario considere le ayudará a mejorar su interacción con la persona.

El Tzolkin o Tzol'kin — la cuenta de los días — es el nombre dado a la versión maya del sincronario o ciclo sagrado de 260 días, constituido por veinte trecenas (o trece veintenas) utilizado en la Mesoamérica precolombina y equivalente al Tonalpohualli azteca.

Es importante responder a las preguntas una vez se ha cambiado la contraseña, o establecer nuevas preguntas con sus respectivas respuestas, ya que se olvidarse se tendría que resetear el programa desde fábrica lo cual implica un costo - no necesario.

Cuando se olvida la contraseña basta con responder correctamente a una de las preguntas para que la contraseña se resetee.

3 REPERTORIZACIÓN PROPEDEÚTICA

Aquí se presentan una serie de cuestionarios breves y ordenados en método y procedimiento de los que se puede valer para observar los signos y síntomas de la persona.

Esta etapa ayuda a inspeccionar, reconocer y clasificar síntomas y signos relevantes de los irrelevantes antes de formular un juicio terapéutico.

Es importante recordar que SOLAMENTE un doctor colegiado puede emitir un diagnóstico clínico .

Un objetivo muy importante de esta etapa es la de crear consciencia en la persona siendo visitada. Muchas personas se estresan al no saber como manejar sus emociones adecuadamente y también por desconocimiento de posibles herramientas que le ayuden en su bienestar diario.

ETAPAS DE SESIÓN

Apertura

Inicio de gENiO® Sapiens desde el 'Escritorio de Windows' -> icono de acceso directo. Carga de bases de datos y establecimiento de comunicación con la caja de interfaz.

Repertorización

Carga de toda la información de la visita. Posibilidad de llenar múltiples cuestionarios para 'crear consciencia' (ISO) y para determinar factores relevantes.

Análisis

Detección de valores relativos de 'reactividad' de la persona frecuencias cuánticas de 260.000 ítems pre-grabadas en gENiO® Sapiens -> Curso de terapia.

Cierre

Última etapa donde se hacen 'últimos retoques' a la terapia para maximizar los resultados y preparar al organismo para el fin del ciclo estimulativo.



Acceso

Introducir contraseña. Preparación del programa para iniciar sesión -> Opción de 'Neutralizar campos energéticos contaminantes'. + 'Calendario

Sincronización

gENiO® Sapiens determina la 'velocidad de reacción del organismo', para en base a ello definir el rango de velocidad más efectivo para enviar frecuencias.

Terapia

Ejecución de curso de terapia definido durante el análisis. No existe una manera 'correcta' o 'incorrecta' o un modelo pre-determinado de efectuarla.

www.sapiensquantum.com

REPERTORIZACIÓN PROPEDÉUTICA

Para agilizar su primera visita con nuestro sistema de biorresonancia gENiO®, le solicitamos que complete tanto como pueda el siguiente cuestionario.

Así mismo, le rogamos haga nota de cualquier inquietud que considere relevante en su búsqueda de bienestar.

Algunas preguntas se responden con una valoración numérica de 0 a 10, o con una valoración de 0 a 10, o donde se indique, con una marca para responder positivamente.

RESPONDE A LAS PREGUNTAS DE LA MANERA MÁS HONESTA POSIBLE

ÍNDICE DE SUPRESIÓN + OBSTRUCCIÓN

0 = Mínimo - 10 = Máximo

| | |
|--|----------------------|
| Número de órganos extirpados | <input type="text"/> |
| Medicaciones sintéticas consumidas actualmente | <input type="text"/> |
| Cigarrillos fumados diariamente | <input type="text"/> |
| Drogas de tipo recreacional / esteroide usadas | <input type="text"/> |
| Amalgamas metálicas presentes | <input type="text"/> |
| Cicatrices / Tatuajes | <input type="text"/> |
| Alergias conocidas | <input type="text"/> |
| Factores emocionales no resueltos | <input type="text"/> |
| Kilos de sobrepeso en opinión de la persona | <input type="text"/> |
| % de cantidad de grasas en dieta (4 = Normal) | <input type="text"/> |
| Productos azucarados consumidos al día | <input type="text"/> |
| Sesiones de ejercicio semanales (20 min. o más) | <input type="text"/> |
| Consumiciones alcohólicas por semana | <input type="text"/> |
| Café, té o productos cafeinados consumidos por día | <input type="text"/> |
| Exposiciones tóxicas extremas por año (Radiación, insecticidas, etc.) | <input type="text"/> |
| Traumas graves físicos o emocionales pasados o presentes | <input type="text"/> |
| Infecciones importantes pasadas o presentes | <input type="text"/> |
| Vasos de agua o zumos naturales bebidos por día (5 = Normal) | <input type="text"/> |
| Considerando todo lo anterior ¿Qué tan responsable es Ud. de su bienestar? | <input type="text"/> |

SEÑALES DE ESTRÉS

0 = Poca - 10 = Bastante

| | |
|---|----------------------|
| Marcada pérdida de la concentración | <input type="text"/> |
| Sensación de cansancio, aún al despertarse | <input type="text"/> |
| Despertar muy temprano, dificultad para dormir o pesadillas | <input type="text"/> |
| Incremento en el consumo de alcohol o cigarrillos | <input type="text"/> |
| Aumento de la irritabilidad | <input type="text"/> |
| Pérdida del sentido de la perspectiva | <input type="text"/> |
| Tendencia a apartarse de actividades sociales | <input type="text"/> |
| Aumento de la susceptibilidad ante las críticas | <input type="text"/> |
| Cambios en los hábitos de alimentación | <input type="text"/> |
| Tensión / Estrés | <input type="text"/> |
| Rebeldía | <input type="text"/> |
| Dolores de estómago en forma de nudos | <input type="text"/> |
| Manos temblorosas | <input type="text"/> |
| Tics nerviosos | <input type="text"/> |
| Pérdida de confianza en sí mismo/a | <input type="text"/> |
| Fallas de la memoria | <input type="text"/> |
| Incómoda sensación de presión | <input type="text"/> |
| Palpitaciones | <input type="text"/> |
| Mandíbula tensa | <input type="text"/> |
| Morderse las uñas | <input type="text"/> |
| Náuseas | <input type="text"/> |
| Diarrea | <input type="text"/> |
| Ataques de pánico | <input type="text"/> |
| Sentimientos de furia, agresión + hostilidad | <input type="text"/> |
| Tendencia a las lágrimas | <input type="text"/> |
| Aspecto descuidado | <input type="text"/> |
| Agitación física, piernas o dedos inquietos | <input type="text"/> |
| Boca seca | <input type="text"/> |
| Manos húmedas, dedos fríos | <input type="text"/> |
| Color gris en la piel | <input type="text"/> |
| Aspecto demacrado | <input type="text"/> |
| Fuertes sentimientos de culpa | <input type="text"/> |

TIPO DE ESTRÉS

0 = Mínimo - 10 = Máximo

| | |
|--|----------------------|
| Estrés interpersonal | <input type="text"/> |
| Estrés laboral o escolar | <input type="text"/> |
| Estrés por pugna con sí mismo o dinero | <input type="text"/> |
| Estrés por afección | <input type="text"/> |
| Estrés familiar | <input type="text"/> |
| Deseo de que las cosas sean diferentes | <input type="text"/> |

MOLESTIAS FÍSICAS

0 = Mínimo - 10 = Máximos

| | |
|--------------|----------------------|
| Intestinos | <input type="text"/> |
| Sudor | <input type="text"/> |
| Orina | <input type="text"/> |
| Mucosidades | <input type="text"/> |
| Menstruación | <input type="text"/> |
| Respiración | <input type="text"/> |
| Piel | <input type="text"/> |
| Sueño | <input type="text"/> |

DIFICULTADES PARA...

0 = Poca - 10 = Bastante

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Relajarse | <input type="text"/> |
| Reposar | <input type="text"/> |
| No decir nada | <input type="text"/> |
| Concentrarse | <input type="text"/> |
| Mantener la concentración | <input type="text"/> |
| Relacionarse con extraños | <input type="text"/> |

0 = nada | 4 = aceptable
8 = excesivo | 10 = exagerado

ISO ESPECIALIZADO - Bebés & Futura Madre

- Tos
- Color de piel amarillento
- 'Calvas' al nacer
- Prueba del 'clic de la cadera'
- 'Rarezas' al nacer
- 'Prueba del talón'
- Cólicos / Diarreas
- Costra láctea
- Anormalidades en genitales
- Manchas de nacimiento
- Respiración mientras llora
- Temperatura corporal / Fiebres
- Dermatitis del pañal o atópica
- Procesos oído-nariz-garganta
- Vómito tras la toma
- Inflamación de los ganglios del cuello
- Estreñimiento
- Reflujo
- Halitosis
- Uno o los dos ojos llorosos
- Ritmos cardíacos / Anomalías
- Calidad del sueño
- Muguet en boca
- Nacimiento por cesárea
- Nacimiento prematuro

PREOCUPACIONES

- Acidez estomacal
- Cambios hormonales
- Desarrollo del feto
- Diabetes gestacional
- Embarazo ectópico
- Oligohidramnios
- Parto prematuro
- Placenta previa
- Preclampsia
- Sueño / vigilia del feto
- Trabajo de parto
- Otro

0 = excelente - 2 = bueno - 4 = aceptable
6 = regular - 8 = malo - 10 = muy malo

HÁBITOS DE LA MADRE DURANTE EL EMBARAZO

- Calidad de la dieta
- Suplementos vitamínicos
- Peso adecuado
- Relajación + Descanso
- Calidad del sueño
- Hidratación
- Tabaco + Alcohol
- Rutinas de ejercicio
- Vida sexual
- Higiene bucal
- Sanidad del entorno físico
- Apoyo de familiares, amigos + pareja
- Seguimientos médicos adecuados
- Responsabilidad durante el proceso
- Madre soltera
- Hijo no deseado
- Inseminación artificial

PÉRDIDA DE SENSIBILIDAD EN ÓRGANOS Y PARTES DEL CUERPO

- Segmentos del cerebro
- Timo
- Desfiguración facial
- Ojo derecho o visión
- Ojo izquierdo o visión
- Oreja derecha o audición
- Oreja izquierda o audición
- Naríz
- Dientes
- Lengua
- Amígdalas / Adenoides
- Tiroides
- Paratiroides
- Mama o parte de linfa
- Pulmón derecho
- Pulmón izquierdo
- Segmentos pulmonares
- Segmentos de huesos
- Brazo derecho
- Brazo izquierdo
- Brazo derecho desde codo
- Brazo izquierdo desde codo
- Mano derecha
- Mano izquierda
- Parte de mano derecha
- Parte de mano izquierda
- Dedos mano derecha
- Dedos mano izquierda
- Falanges mano derecha
- Falanges mano izquierda
- Parte de columna vertebral o vertebras
- Parte de estómago
- Intestino grueso
- Segmento del intestino grueso
- Intestino delgado
- Segmento del intestino delgado
- Riñón derecho
- Riñón izquierdo
- Bazo
- Apéndice
- Vesícula biliar
- Segmento de pelvis
- Útero
- Ovarios
- Testículos
- Próstata
- Prepucio
- Pierna derecha
- Pierna izquierda
- Pierna derecha desde rodilla
- Pierna izquierda desde rodilla
- Pie derecho
- Pie izquierdo
- Parte de pie derecho
- Parte de pie izquierdo
- Dedos pie derecho
- Dedos pie izquierdo
- Segmentos hepáticos
- Segmentos de venas
- Segmentos de nervios
- Otros

BIENESTAR GENERAL

- Tomar alimentos tratados + no comer vegetales frescos
- Boca seca al comer + no masticar correctamente
- Deseo líquidos al comer + hinchazón o eructos después de comer
- Poca absorción en el intestino delgado
- Gases rectales excesivos
- Dolor en la válvula ileocecal o en la de Houston
- Sistema inmune debilitado por el estrés emocional
- Dificultad para mantener la estabilidad corporal + la temperatura
- Condiciones fecales: flotación, hedor, grasosidad, pegajosidad o coloración
- Desórdenes en el conteo de las células sanguíneas
- Dolor de garganta recurrente
- Susceptibilidad a hongos, bacterias o cáncer
- Susceptibilidad a infecciones por hongos
- Sangre intoxicada ahora o en el pasado
- Problemas urinarios o de crecimiento
- Dificultad para despertarse por la mañana a primera hora
- Problemas de metabolismo
- Problema cardíaco
- Desorden respiratorio
- Desorden de azúcar en sangre
- Infección o afección de colesterol
- Cansancio + fatiga constantes
- Desorden del sistema sexual
- Incapacidad para controlar pensamientos sexuales o enfados
- Preocupación excesiva
- Problemas en la cavidad nasal
- Deseo de alimentos salados
- Deseo de alimentos sazonados
- Deseo de alimentos dulces
- Deseo o aborrecimiento de alimentos amargos
- Deseo de alimentos agrios
- Tristeza excesiva
- Ansiedad constante
- Temor excesivo
- Problemas al plantearse el futuro
- Sentirse amado o amador
- Voluntad débil
- Responder a las necesidades del cuerpo
- Espíritu sosegado

LESIONES CORPORALES

- Daño de flexión
- Extensión / hiperextensión
- Abductores
- Vascular
- Fracturas
- Subluxación / Pronación / Supinación

LESIONES RESULTANTES EN INCAPACIDAD

- Incapacidad emocional
- Incapacidad por dolor
- Incapacidad por infección
- Ausencia de movilidad
- Incapacidad general no especificada
- Describir brevemente

TIPO DE AFECCIÓN

- Cardíaca
- Cerebral
- Circulatoria
- Degenerativa
- Endocrina
- Genética
- Huesos / Esqueleto
- Inmunológica
- Infecciosa
- Intestinal
- Lesión o trauma
- Lesión quiropráctica
- Muscular
- Nerviosa
- Psicológica
- Dermatológica
- Pulmonar
- Sanguínea
- Sensorial

Diagnosis

NOTAS
APUNTES
COMENTARIOS
PREGUNTAS

OTRAS CONDICIONES O HISTORIAL

- Afeción vascular o circulatoria, extremidades frías, arterias o venas
 - Infección
 - Neoplasma, posibilidad de cáncer, tumor o afeción degenerativa
 - Problemas dietéticos o posible problema de exceso de entrada o absorción
 - Intoxicación, posible adicción a drogas o posibles exposiciones tóxicas
 - Desorden congénito, hereditario o de nacimiento
 - Alergia, tendencia o predominio de síntomas alérgicos
 - Trauma o lesión relacionada con problemas de cualquier tipo
 - Disturbio endocrino, hormonal, glandular o problema de regulación
 - Problemas emocionales relacionados con creencias de la persona
 - Estrés relacionado con creencias de la persona
 - Problema de tacto, vista, oído, gusto, sentimiento u olfato
 - Contaminación electromagnética, exceso de humedad, calor, frío, sequedad, o radiación
 - Falta de atención o consciencia
- Otra
-

EXPOSICIONES A TOXINAS

- Tiendas de cosméticos o similares
- Asbestos de materiales aislantes o similares
- Industriales
- Pesticidas o insecticidas
- Metales pesados
- Aditivos alimentarios
- Radiación
- Clorina o fluorina
- Agua o aire
- Exposición a infecciones

TRAUMAS POR CONDICIONES HEREDITARIAS

- Por parte de familia paterna
- Por parte de familia materna

Describir

NOTAS
APUNTES
COMENTARIOS
PREGUNTAS

TIPO DE FÁRMACOS CONSUMIDOS

- Esteroides
 - Corazón o sistema cardiovascular
 - Dolor
 - Presión sanguínea
 - Anginas
 - Diluyentes sanguíneos
 - Colesterol
 - Riñones
 - Reguladores del humor / estados de ánimo
 - Antiespasmódicos
 - Antipsicóticos y neurolépticos
 - Relajantes musculares
 - Antibióticos
 - Cáncer o quimioterapia
 - Reguladores del humor / estados de ánimo
 - Antiespasmódicos
 - Antipsicóticos y neurolépticos
 - Relajantes musculares
 - Antibióticos
 - Cáncer o quimioterapia
- Otra
-

4 SINCRONIZACIÓN

Sincronizar: Hacer que dos o más hechos, fenómenos, movimientos, mecanismos, etc., sean sincrónicos, estén en perfecta correspondencia temporal.

Uno de los conceptos más interesantes que manejamos dentro de gENiO® Sapiens es el de **Potencial Evocado**, que es definido como la capacidad natural de respuesta de un organismo antes estímulos tanto internos como externos.

Un organismo sano tiene la capacidad de responder más rápido y mejor antes tales estímulos, que la de un organismo enfermo. Este índice de velocidad de respuesta es muy importante dentro del proceso de 'sincronización'.

Una vez se han introducido los datos de la persona (entre cuantos más mejor), gENiO® iOS calculará el rango de velocidad más apropiado a la cual enviar las frecuencias eléctricas-informantes, para efectos del 'Análisis' y posteriores estimulaciones durante la

Si las frecuencias eléctricas-informantes fuesen enviadas a una velocidad muy rápida, entonces el organismo no tendría la oportunidad de captar, asimilar o 'entender' dichas frecuencias.

Si por el contrario tales frecuencias eléctricas-informantes fuesen enviadas a una velocidad muy lenta, entonces más allá de obtener un valor de 'Reactividad', se obtendría un valor de 'Resonancia' el cual es un parámetro muy diferente del que se pretende obtener durante el 'Análisis'.

Durante la Sincronización también se miden y calculan otros parámetros necesarios para un 'Análisis' más certero y fiable. Una explicación de los fundamentos de tales parámetros pueden ser consultados en el documento 'Interpretación De Términos'.

ETAPAS DE SESIÓN

Apertura

Inicio de gENiO® Sapiens desde el 'Escritorio de Windows' -> icono de acceso directo. Carga de bases de datos y establecimiento de comunicación con la caja de interfaz.

Repertorización

Carga de toda la información de la visita. Posibilidad de llenar múltiples cuestionarios para 'crear consciencia' (ISO) y para determinar factores relevantes.

Análisis


Detección de valores relativos de 'reactividad' de la persona frecuencias cuánticas de 260.000 ítems pre-grabadas en gENiO® Sapiens -> Curso de terapia.

Cierre

Ultima etapa donde se hacen 'últimos retoques' a la terapia para maximizar los resultados y preparar al organismo para el fin del ciclo estimulativo.



www.sapiensquantum.com

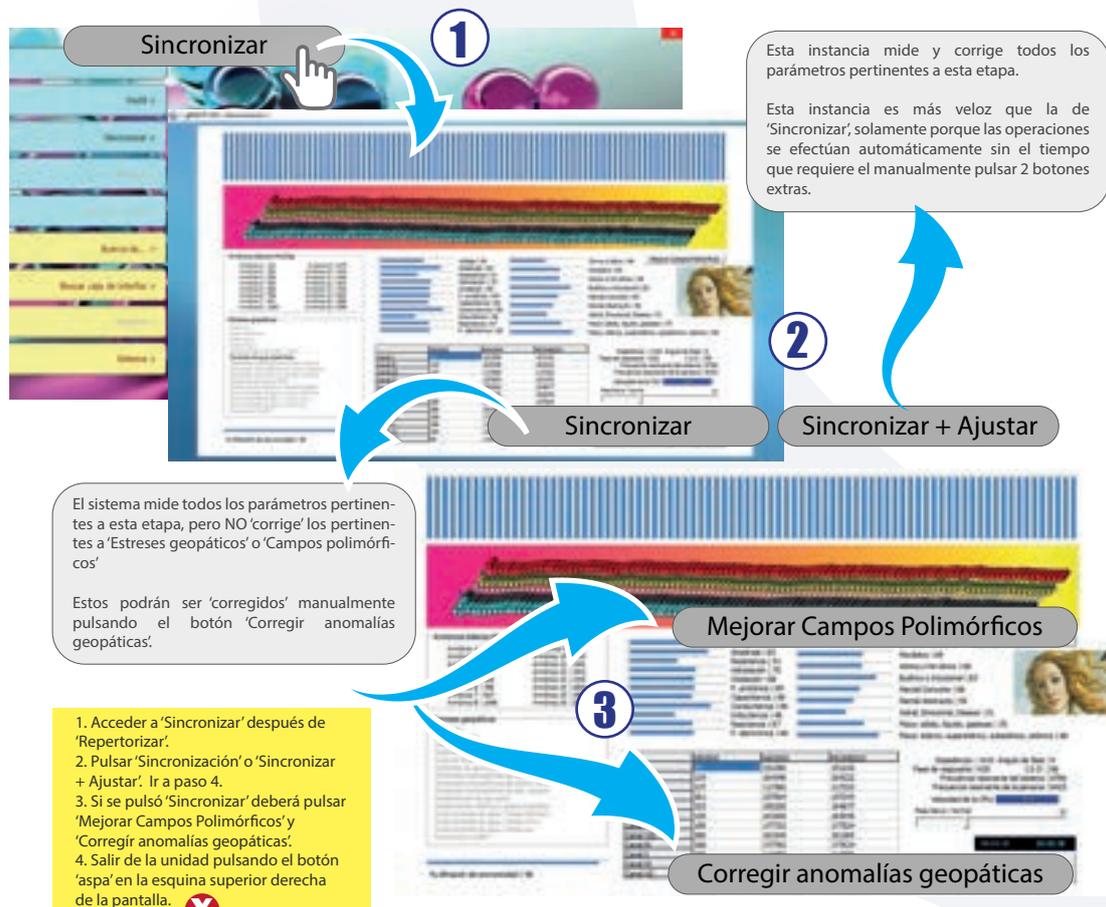

5 ANÁLISIS

ANALIZAR: (Verbo transitivo). Examinar detalladamente una cosa, separando o considerando por separado sus partes, para conocer sus características o cualidades, o su estado, y extraer conclusiones. p.e. "analizar la sangre de una persona".

El tiempo promedio del 'Análisis' es de 30 a 120 segundos, dependiendo de la velocidad del ordenador. Estos tiempos son una reducción drástica en tiempos de análisis en versiones anteriores del software debido a que usamos un procedimiento llamado 'multi-hilos' que permite asignar funciones por bloques a cada procesador del ordenador para analizar, clasificar y catalogar hasta 8 ítems al mismo tiempo sin sacrificar la integridad de la información.

ETAPAS DE SESIÓN

Apertura

Inicio de gENiO® Sapiens desde el 'Escritorio de Windows' -> icono de acceso directo. Carga de bases de datos y establecimiento de comunicación con la caja de interfaz.

Repertorización


Carga de toda la información de la visita. Posibilidad de llenar múltiples cuestionarios para 'crear consciencia' (ISO) y para determinar factores relevantes.

Análisis

Detección de valores relativos de 'reactividad' de la persona frecuencias cuánticas de 260.000 ítems pre-grabadas en gENiO® Sapiens -> Curso de terapia.

Cierre

Ultima etapa donde se hacen 'últimos retoques' a la terapia para maximizar los resultados y preparar al organismo para el fin del ciclo estimulativo.

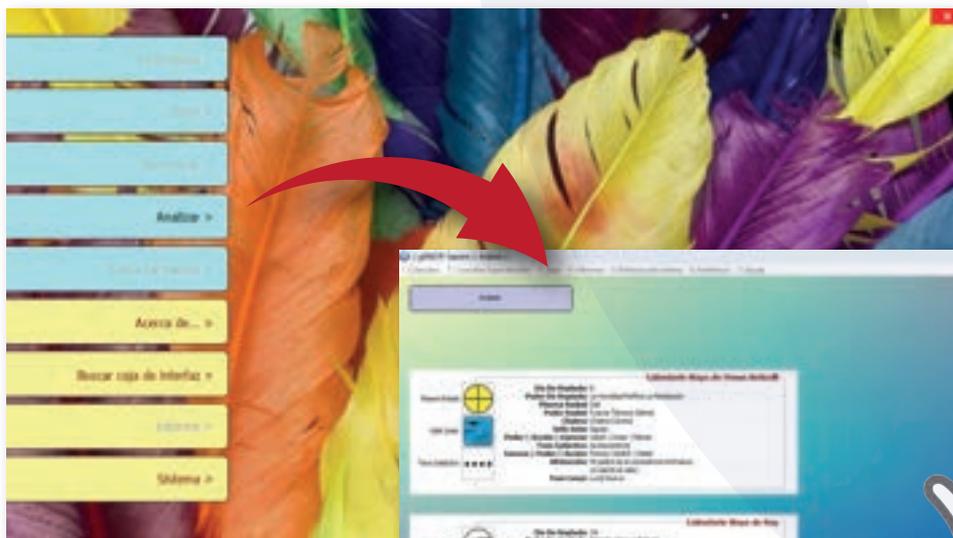


Esta función se suele emplear en la primera visita para animar a una mejor reactividad del organismo justo antes del análisis.

Inicia el proceso de 'análisis'.

Calendarios Maya o Tzolkin de la persona siendo visitada y del día actual.

Valores eléctricos de la persona de la sesión en curso.

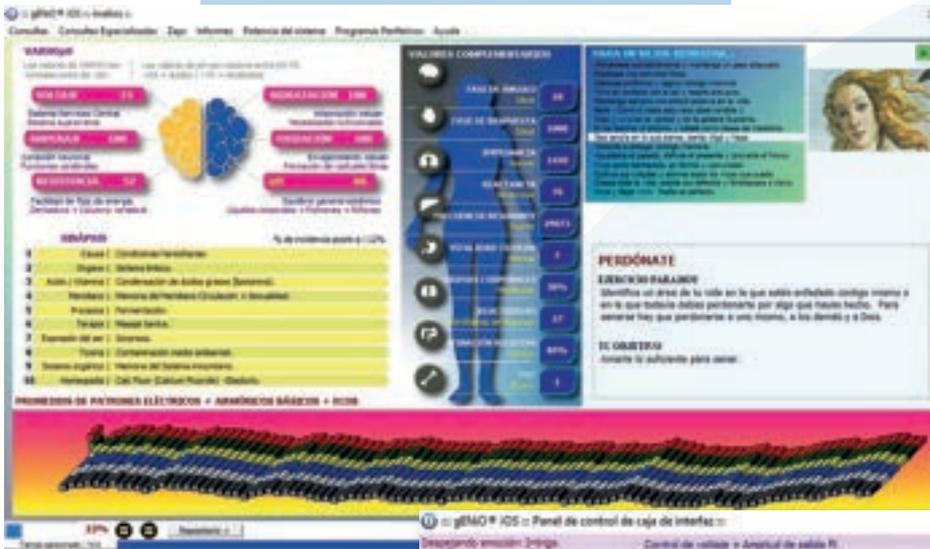

La imagen de la persona es parte fundamental durante una sesión de tipo 'cuántico'. Esto está basado en la teoría de los 'Estados entrelazados de la materia'.

Consejos para la persona. Las frases positivas y la inducción a la proactividad son parte esencial de la reducción del estrés.

Durante el 'Análisis' este panel indicará que el proceso de compilación de datos se ha iniciado. Este proceso es fundamental ya que todos los valores en los cuales se basará la terapia dependerán en al menos un 95% del correcto procesamiento, almacenamiento, y tratamiento de esta información.



Este 'Panel de control de caja de interfaz' se mostrará unas cuantas veces durante el 'Análisis'. Este indica la actividad de recepción y transmisión de datos entre el hardware y el software del sistema.

Una vez asignados los valores de reactividad a los más de 200.000 ítems en la matriz del programa, la primera función es la de segmentar los diferentes grupos y asignarles un valor medio, para así determinar un valor por grupo que permite ver la reactividad por grupo. Esta información es particularmente relevante para determinar un cauce de terapia.



Se muestra en forma de 'Campana de Gauss' la UNIDAD TIPIFICADA de la matriz (250.000+ ítems), que es una variable centrada reducida, estandarizada y normalizada que estadísticamente compara los datos procedentes de diferentes muestras o grupos de la matriz. Se han dividido en 6 'desviaciones típicas' (3 inferiores y 3 superiores), a partir del rango de valores más repetidos durante el 'Análisis'. Las estadísticas de algunos de los resultados del 'Análisis' son mostradas gráficamente y contextualmente, para una mejor INTERPRETACIÓN por parte del profesional.

A partir de aquí el profesional puede seguir el curso de acción que considere más oportuno para la persona.

6 TERAPIA DE BIORRESONANCIA CUÁNTICA

ETAPAS DE SESIÓN

Apertura

Inicio de gENiO® Sapiens desde el 'Escritorio de Windows' -> icono de acceso directo. Carga de bases de datos y establecimiento de comunicación con la caja de interfaz.

Repertorización

Carga de toda la información de la visita. Posibilidad de llenar múltiples cuestionarios para 'crear consciencia' (ISO) y para determinar factores relevantes.

Análisis

Detección de valores relativos de 'reactividad' de la persona frecuencias cuánticas de 260.000 ítems pre-grabadas en gENiO® Sapiens -> Curso de terapia.

Cierre

Ultima etapa donde se hacen 'últimos retoques' a la terapia para maximizar los resultados y preparar al organismo para el fin del ciclo estimulativo.



TERAPIA HOLÍSTICA E INTEGRATIVA



El sistema gENiO® Sapiens debe su desarrollo a una nueva visión que es cada vez más común, donde todo lo existente es interpretado como energía en diferentes formas de manifestación.

Desde el punto de vista de la cuántica, cuando un organismo pierde la capacidad para mantener sus funciones en forma ordenada y armónica, aparece lo que conocemos como afección. Este desorden puede expresarse en cualquier órgano o tejido según cada persona y es por ello que cada cual desarrolla una afección distinta y con los síntomas particulares que es capaz de manifestar.

gENiO® Sapiens es un sistema de biorresonancia integral e integrativo que generara frecuencias sanadoras sutiles dentro de unos rangos pre-programados cuyo objetivo es hacer que el propio organismo las asimile para que este se sane a sí mismo - tal cual explica la 'Medicina Tradicional China' en referencia a la 'FUERZA VITAL' de todo organismo vivo.

Consultas

- Acupuntura + Reflexología
- Antroposófica + Metutelet
- Biofeedback + Neurobiofeedback
- Biofrecuencias
- Biorresonancia 'Rife' + Electrobiología + Genética + Pulsología China + Meridianos + 5 Movimientos + Diagnóstico por la lengua + Alergología + Scalar
- Biosónica + Cronobiología
- Chakra + Campos Auricos
- Craneo Sacral
- Dinámicas Neuro-Psicológicas
- Espectro Energético-Vibracional / Espectroscopia Vibracional
- Estimulación Neuro Cerebral + Psicofisiología
- Facioterapias + Terapias Corporales
- Hematología + Células Madre + Serología + Virología + Nutrición + Dietética + Obesidad + Parasitología
- Homeopatía + Fórmulas Maestras + Microdosis + Flores de Bach + Tarjetas Electromagnéticas
- Homotoxicología + Toxicología + Ayurvédica + Oncología + Histología + Epigenética + Inmunología + Adicciones + pH
- Neuro Anatomía + Algología + Afecciones Raras + Terapia Neural + Anestesiología
- Neurología + Patrones Eléctricos Cerebrales + Electrocardiograma
- Odontología Neurofocal + Estomatología + Odontopediatría
- Pares Biomagnéticos
- Patrones Conductuales + Circuitos De La Memoria + Epilepsias
- Perfil Neuro-Psico-Celular
- Procesos inflamatorios + Síndrome de disfunción multiorgánica (SDMO)
- Psicobiología
- Psicopercepción + Estimulación Celular + Rejuvenecimiento + Epigenética
- Radiología + Ortopantomografía
- Rife fx
- Sarcodes + Homeopatía / Organoterapia
- Sistemas + Aparatos Orgánicos
- Trofología + Fertilidad + Celiaquía + Nutrición Ortomolecular + Oligoelementos + Vitaminas + Minerales

- Acupuntura MTC
- Auriculopuntura
- Iridiología
- Reflexología De Mano
- Reflexología Facial
- Reflexología Podal

MENÚ DE TERAPIAS

Consultas Especializadas

- Alergología
- Algología + Condiciones raras
- Angeloterapia
- Biorrítmos
- Biovoltimetría
- Exámenes psicológicos
- Expresiones del Ser + Neurotransmisores
- Generador de Campo Orgón
- Numerología
- Mejora del rendimiento
- Programas metafísicos
- Repositorio
- Terapias automáticas

Cambiar imagen de visita actual

Ctrl+I

gENiO® Sapiens cuenta con cientos de terapias que cubren todos los aspectos necesarios en cualquier consulta de tipo integrativo.

Así mismo, su flexibilidad de uso la hacen ideal para practicamente cualquier tipo de usuario bien sea principiante o experimentado.

MECANISMO DE ACCIÓN

NO SE REQUIERE UNA CONEXIÓN FÍSICA CON LA PERSONA PARA REALIZAR UN COMPLETO ANÁLISIS.



SOLO SE REQUIERE UNA PEQUEÑA MUESTRA ORGÁNICA DE ACUERDO A LA TERORÍA DE LOS 'ESTADOS ENTRELAZADOS DE LA MATERIA'.

7 CIERRE DE SESIÓN

La naturaleza 'abierta' de gENiO® Sapiens es una de sus bondades más reconocidas, es decir, el usuario no debe seguir un protocolo predeterminado en su búsqueda de la manera más efectiva de reducir el estrés en la persona que se visita con el sistema.

Sin embargo, durante el transcurso normal de una sesión recomendamos cierta manera 'amable' de dar por concluida la

En tanto en cuanto hablamos de una sesión de terapia con gENiO® Sapiens como un diálogo principalmente con el subconsciente de la persona, es bien recomendable tener alguna manera de indicar al mismo, que la sesión ha finalizado. Es bien obvio por otra parte, que un protocolo de 'final de sesión' en realidad favorece a todas las partes involucradas.

Una vez se decida el cierre de sesión, este pequeño protocolo de "Gracias, hasta la próxima", es muy sencillo y elegante para dar la sesión por concluida.



1 Cierre de sesión >

Puede también directamente pulsar cualquiera de los botones 'fx' de la parte superior de la pantalla. El botón marcado en **negrita**, es el sugerido por el sistema.

3

Puede pulsar sobre cualquier etiqueta para realizar una estimulación puntual. Las etiquetas marcadas en azul claro, son las áreas sugeridas por el sistema.

2

Iniciar terapia fx

4

Pulsar el botón 'Iniciar fx' para estimular. Una vez finalizada, el programa se cerrará automáticamente.

ELEMENTOS COMUNES

Una de las características que más facilitan la tarea del profesional durante el uso de gENiO® Sapiens es que todos los elementos que son comunes a todas las unidades del programa están situados en el mismo sitio.

Así mismo, la interfaz presenta ciertas características que facilitan la navegación e identificación de funciones.

Encabezado de la unidad

gENiO® Sapiens :: Nombre De La Unidad ::

Botón de estímulo (por norma general un estímulo dura 2-3 min.)

Texto De Botón

Los biomarcadores son elementos anexos a la estimulación que se hace y que la refuerzan, al mismo tiempo que brindan ideas extras sobre la estimulación en curso

Biomarcadores

- Biomarcador 1
- Biomarcador 2
- Biomarcador 3
- Biomarcador 4
- Biomarcador 5
- Biomarcador 6
- Biomarcador 7
- Biomarcador 8
- Biomarcador 9
- Biomarcador 10
- Biomarcador 11
- Biomarcador personalizado 1
- Biomarcador personalizado 2
- Biomarcador personalizado 3

Imagen de la persona visitada

Gráfico frecuencial que muestra la fluctuación del 'VARHOpH' durante la estimulación

El caracter '>' indica que es un botón que abre otras opciones

Texto De Botón >

Los botones 'eX' se activan cuando en el cajetín de edición se introduce algún tipo de texto

Botón encontrado en la esquina superior derecha de un panel para ocultarlo

Introducir ítems relevantes a la estimulación a realizar

Esta opción se activa cuando en el cajetín de edición precedente se copia algún texto del panel siendo usado. Al pulsarse el panel se cierra y el texto se transfiere al primercajetín 'Mantener:' en 'Análisis'

Cambia el tiempo del estímulo al tiempo deseado (hasta 24 h.)

Marcador de 'Rectificado final'

Icono de reseteo para activar botones o etiquetas desactivadas

Tiempo de duración total del estímulo

Abre panel con menú de unidades para ir allí directamente sin cerrar la unidad actual

Carga la unidad 'Repositorio' para añadir o editar las frecuencias extras que se utilizan durante los estímulos

Indica en segundos el tiempo que tardará el estímulo siendo aplicado

Indica el porcentaje realizado del estímulo siendo aplicado

Mantiene el estímulo activo hasta cuando se alcance un 'rX' de +84

Una vez que la estimulación ha alcanzado un porcentaje +84, activa el 'Generador de campo Orgón' y lo mantiene activo hasta que se cierre manualmente.

Hora actual

Tiempo de apertura del programa

www.sapiensquantum.com

ESPECIFICACIONES GENERALES

Categoría: Biorresonancia, Cuántica, Biofeedback, Data, Análisis

Clasificación de software: 'Medical Device Software' Class A NOT in accordance with the criteria of the IEC 62304 standard in accordance with ISO 13485, que en particular incluye y cubre en particular 'Stand-alone medical software'

Fecha de liberación ver. 2024: 30/05/2023

Idiomas del software: Castellano, inglés

Tamaño del programa en disco: 8.58 GB

Sistemas Operativos: Windows 10, Windows 11

Pre-requisitos del software: Microsoft Visual C++ 2010, Microsoft Visual C++ 2012, Microsoft Visual C++ 2013, Microsoft Visual C++ 2015, MySQL Connector/ODBC 5.3

Programas periféricos del software: 'Corpos', 'Hamer', 'Lexicon', 'Holos'

Programas utilitarios del software: 'Noé'

Especificaciones mínimas del ordenador: Processor iCore7, RAM 12 GB

Conexión a Internet: Requerida para la instalación, activación, actualización y cualquier tipo de soporte técnico requerido. No se requiere durante el uso normal del software

Autor / Desarrollador: Francisco Martínez para Comunicación Bioinstrumental, SL

Programación: Francisco Martínez, Daniel Fernando González Peña

Propietario del software: Comunicación Bioinstrumental, SL (Barcelona - España)

IDE: Delphi® Embarcadero

Tipo de bases de datos: MySQL

Publicación / Distribución: Comunicación Bioinstrumental, SL & Laboratorio Tecnonatura, SAS

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

1. OBJETIVO PRINCIPAL

Para uso profesional principalmente. Se considera al usuario y los tiempos de la sesión. El software muestra claramente la información más relevante que siempre está lista para ser usada.

2. EXTENSIBILIDAD & ESCALABILIDAD

Nuevas unidades, módulos, paneles y bases de datos pueden ser añadidos fácilmente sin cambios drásticos en la estructura o arquitectura del programa.

3. RESTRICCIONES DE TIEMPO DEL USUARIO

‘Cada minuto cuenta’. El usuario dispone de la información más relevante siempre para realizar la mayor cantidad de actividades en un tiempo específico.

4. TIEMPOS DE SESIÓN

Se recomiendan tiempos de terapia de entre 45 minutos y 120 minutos - Aun cuando se pueden extender los tiempos de terapia de acuerdo al criterio del usuario.

5. CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA Y HABILIDAD DEL USUARIO

El usuario promedio deberá poseer conocimientos básicos de informática. El software es muy amigable y fácil de navegar.

6. INTERACCIÓN ENTRE EL USUARIO Y EL SOFTWARE

Dada la cantidad de información y el objetivo del software, la información es presentada de una manera muy gráfica para hacerla más fácil de interpretar y usar.

7. FIABILIDAD

Debido al tamaño del software por la cantidad de información que debe ser procesada, todos los procesos de cálculo han sido centralizados y una función específica creada para obtener el máximo rendimiento del hardware. Así mismo la gran mayoría de operaciones se han limitado entre 2 y 3 minutos para obtener el máximo provecho de las bondades del sistema.

8. RENDIMIENTO

El software realiza todas las tareas dentro de tiempos establecidos e indicados en la barra de tareas, utilizando siempre la menor memoria posible sin comprometer los resultados o sus funciones.

9. ROBUSTEZ

El software es intuitivo a través de su ‘Memoria Artificial’ y ofrece ‘consejos’ al usuario, al tiempo que habilita y deshabilita botones si algún paso es requerido o si el paso ya se ha efectuado. El software compila datos en sus 1.000 bases de datos.

10. TOLERANCIA DE FALLOS INFORMÁTICOS

El software está programado para recuperarse rápidamente de cualquier fallo interno del ordenador o del Sistema Operativo p.e. que algún procesador falle. De otra manera un re-inicio del software permite la recuperación de la sesión que fue interrumpida abruptamente.

11. SEGURIDAD & ACTA DE PROTECCIÓN DE DATOS

No se ha programado una contraseña por defecto. La primera vez que se graba un usuario nuevo, se debe crear una contraseña y responder a las preguntas de recuperación. Cualquier contraseña se puede editar en cualquier momento. En cumplimiento del Acta de Protección de Datos 2018, solamente el Administrador del sistema puede acceder a toda la información de los registros guardados en el sistema.

12. PORTABILIDAD & ADAPTABILIDAD

La caja de interfaz ha sido diseñada pensando en la portabilidad del sistema para que con dimensiones y peso reducidos sea muy fácil de transportar, y así adaptarse a cualquier tipo de consulta.

13. MODULARIDAD

The software comprises a well-defined, independent component which leads to better maintainability. The components have been implemented and tested in isolation before being integrated into the software system. This has allowed division of work in the development project.

14. CONSISTENCIA DE LOS RESULTADOS

Este principio ha sido primordial a la hora de elegir 'SQL' como gestor de bases de datos para el sistema.

15. MANTENIMIENTO

Este punto como resultado de la modularidad, la escalabilidad y la extensibilidad del software; hace que generar 'Paquetes de Servicio' para corregir pequeños fallos que en su mayoría surgen como resultado de las actualizaciones del Sistema Operativo, sea una tarea relativamente fácil y rápida de implementar.

16. MULTIDISCIPLINA

El software es una herramienta muy versátil que puede ser empleada en cualquier tipo de consulta de tipo 'alternativo', 'complementario' o en definitiva de disciplinas reconocidas como 'NO MÉDICAS' como las de 'biorresonancia'.

LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE

Este es un acuerdo legal entre usted, el usuario, y 'Comunicación Bioinstrumental, SL' ('Empresa'). Al instalar o al descargar el software, o usar el software que ha sido cargado o pre instalado en su ordenador, usted acepta los términos de este acuerdo. Si no está de acuerdo, devuelva los elementos del software (discos, memoria externa, manuales escritos, etc.), y borre el software cargado o instalado en su ordenador.

Puede usar una copia del software en tan solo un ordenador al mismo tiempo. Si tiene licencias múltiples del software, usted podrá tantas copias como correspondan al número de licencias. 'Usar' quiere decir cargar el software en la memoria temporal o en el disco duro del ordenador. Instalación del software en una red solamente para la distribución a otros ordenadores no es 'uso' si (y solamente si), usted tiene licencia para los ordenadores a los cuales el software es distribuido. Debe asegurarse que el número de personas que usan el software instalado en una red no excede el número de licencias que se poseen. Si el número de usuarios del software instalado en una red excede el número de licencias, usted debe comprar licencias adicionales hasta que el número de licencias sea igual al número de usuarios antes de permitir uso adicional del software. Si usted es usuario comercial de la 'Empresa' usted garantiza a la empresa o a un agente seleccionado por la 'Empresa' el derecho a realizar una auditoría del software en horas de oficina, usted accede a cooperar con la 'Empresa' en tal auditoría, y accede a proveer a la 'Empresa' con todos los registros razonables relacionados con el uso del software. La auditoría se limitará a verificar su cumplimiento de este contrato. Este software está protegido por derechos de autoría y tratados internacionales. Usted podrá hacer una copia del software solamente para su transferencia a un disco duro, siempre y cuando conserve el original para propósitos de seguridad. Usted no podrá alquilar o vender el software o copiar los materiales escritos que acompañan el software, pero usted puede transferir el software y todos los materiales escritos que le acompañan, a otra persona de modo permanente si usted no retiene copias y el receptor accede a estos términos. Cualquier transferencia debe incluir el material y software actual incluyendo versiones anteriores. Usted no deberá tratar de descompilar, forzar, o sabotear el software.

Garantía limitada

La 'Empresa' garantiza que los discos del software estarán libres de defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de uso normal de noventa (90) días a partir de la fecha que usted recibe el software. Esta garantía está limitada a usted y no es transferible. Cualquier garantía implicada está sujeta a un periodo de noventa (90) días desde la fecha que usted recibe el software. Algunas jurisdicciones no admiten límites en la duración de garantías implicadas por lo que esta limitación es posible que no le afecte. La responsabilidad máxima de la 'Empresa' y sus proveedores, y su único remedio, será (a) la devolución del dinero pagado por el software o (b) el reemplazo de cualquier disco que no cumpla con los requisitos de esta garantía y que serán enviados bajo su costo y riesgo. Esta garantía limitada no es válida si el daño de algún disco es como resultado de accidente, abuso, uso indebido o erróneo, servicio o modificación por alguien otro a la 'Empresa'. Cualquier disco de reemplazo es garantizado por el tiempo restante de la garantía original o treinta (30) días, cualesquiera sea el periodo más extenso. La 'Empresa' NO garantiza que las funciones del software corresponderán a sus requerimientos o que la operación del software será no-interrumpida o libre de errores. Usted asume la responsabilidad por seleccionar el software adecuado para los resultados pretendidos y para el uso y resultados obtenidos de este software. La 'Empresa' DEROGA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLICADAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO A, GARANTÍAS IMPLICADAS DE MERCABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, DE ESTE SOFTWARE Y TODOS LOS MATERIALES QUE LE ACOMPAÑAN. Esta garantía limitada le da derechos legales específicos; usted podrá tener otros, que varían de jurisdicción a jurisdicción. BAJO NINGÚN EVENTO LA 'EMPRESA' O CUALQUIERA DE SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE GANANCIAS MONETARIAS, INTERRUPTIÓN DE RENTA, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL, O CUALQUIER OTRO TIPO DE PÉRDIDA PECUNIARIA), COMO RESULTADO DEL USO O INHABILIDAD DE USAR ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. Debido a que algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de obligaciones por daños consecuenciales o incidentales, es posible que esta limitación no sea aplicable en su caso.

Derechos restringidos por el gobierno de los EE. UU.

Este software y documentación son 'elementos comerciales' como se define en el acta 48 C.F.R. 2.101, consistiendo de 'software informático comercial' y 'documentación de software informático comercial' tal y como se usa en el acta 48 C.F.R. 12.212. Consistente con 48 C.F.R. 12.212 y 48 C.F.R. 227.7202-4, todos los usuarios que adquieren el software y documentación con solo los derechos establecidos por este contrato, siendo el fabricante la 'Empresa', Sepúlveda 46, 2-2, Barcelona - 08015 (España).

General

Esta licencia es efectiva hasta que expire. Expirará bajo las condiciones establecidas arriba, o si usted no cumple con cualquiera de las condiciones. En expiración, usted accede a que el software y todos los materiales que le acompañan, y copias de estos, sean destruidos. Este acuerdo está sujeto a las leyes internacionales. Cada provisión de este contrato es separable. Si alguna provisión no se puede aplicar, este hallazgo no afectará la aplicabilidad de las provisiones, términos o condiciones restantes de este contrato. Este contrato es vinculante a sucesores y adscritos. La 'Empresa' accede y usted accede a renunciar, al máximo permitido por la ley, a cualquier derecho, a un jurado o decisión legal con respecto al software o este contrato. Debido a que esta renuncia puede no ser aplicable en algunas jurisdicciones, esta renuncia puede no aplicar a usted. Usted reconoce que ha leído y entendido este contrato, y accede a cumplir las condiciones, y a que este escrito es el texto completo de este contrato entre usted y la 'Empresa' en referencia al software.

Barcelona, 30 de mayo de 2023

ETIQUETA DEL SISTEMA

NOMBRE DEL PRODUCTO:
SISTEMA gENiO



FABRICANTE:
Comunicación Bioinstrumental, SL
Sepúlveda 46, 2-2
08015 - Barcelona
España
Teléfono: +34 647 55 03 24
NIF: B67857334

IMPORTADOR (Colombia):
Laboratorio Tecnonatura, SAS
Cra. 93 #71A-39
Bogotá - Colombia
Teléfono: +57 320 842 5546
NIT: 900474989-7

| | |
|-----|--------------|
| REF | CONSTELACIÓN |
| LOT | AAAAMMDD000 |

SAPIENS
La naturaleza es sabia.



Consulte el manual técnico.



Consulte el manual de uso.



Proteja de la luz solar directa.




Conservar en temperaturas comprendidas entre 5 °C (41 °F) - 35 °C (95 °F).



Proteja del agua.

1. El número de 'LOTE' se interpreta: los primeros 4 dígitos corresponden al año, los siguientes 2 dígitos al mes, los siguientes 2 dígitos al día y los últimos 4 dígitos al número asignado a cada unidad.
2. La etiqueta va adherida en la parte inferior de la caja de interfaz como se muestra en el gráfico.

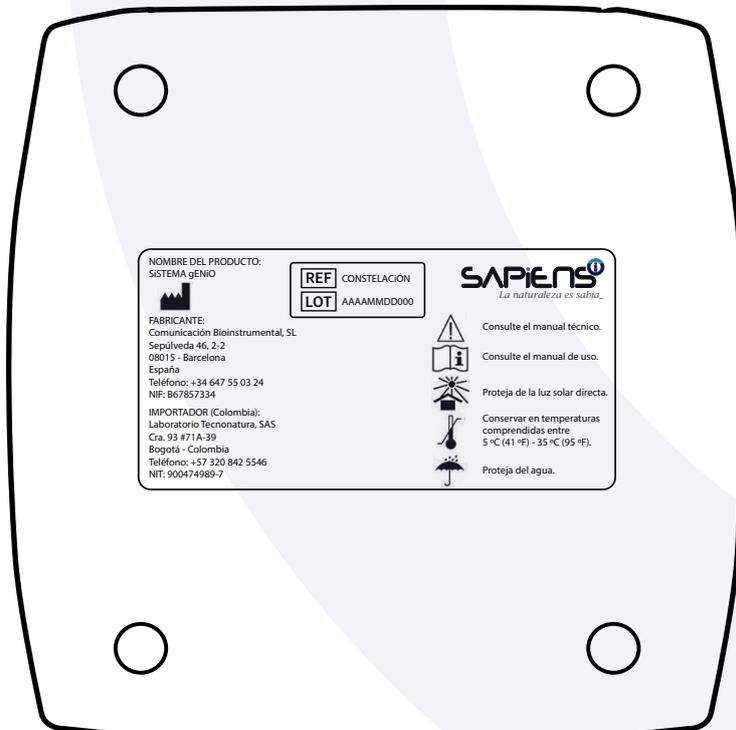

PRESENTACIÓN COMERCIAL



1. El software es descargado, instalado y activado en el ordenador / computadora del usuario vía remota.
2. El usuario recibe la caja de interfaz vía mensajería, junto con el cable conector USB-USB, empacados en 'papel de burbújas', dentro de una bolsa transportadora con el logo de la caja de interfaz, tipo 'sobre' que se cierra por medio de un elástico.
3. El usuario retira el 'papel de burbújas', limpia la caja de interfaz con un paño suave húmedo, y conserva la bolsa para el transporte de la caja de interfaz.

NOTAS DEL USUARIO